

„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.
ul. Lutycka 34/budynek A, 60-415 Poznań
tel.: +48 61 415 27 03, 61 855 35 10
e-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl

SzW/5/2022

Poznań, 02 maja 2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SZW

Dotyczy: **Zakupu i montażu podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami (poruszającymi się na wózkach) jak i dla matek z dziećmi** – znak sprawy SzW/5/2022.

Zamawiający, **Szpitale Wielkopolski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) (zwanej dalej: ustawa Pzp), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:



Pytanie nr 1: Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie parametrów technicznych dotyczących zakupu i montażu podnośnika dla niepełnosprawnych. W opisie oraz na rysunkach mieszają się określenia i parametry platformy schodowej oraz podnośnika dla niepełnosprawnych. Platforma schodowa nie posiada drzwi oraz ma inne wymiary. Nie może też przewozić wózków dziecięcych z osobą towarzyszącą. Proszę o wyjaśnienie lub możliwość umówienia spotkania na obiekcie najlepiej na 5go maja.

Odpowiedź: Przetarg dotyczy platformy przyschodowej mocowanej na słupkach/szynie do stopni schodów. W miejscu określenia drzwi w opisie należy rozumieć pałąki/barierki ochronne, po których zwolnieniu wymagane jest światło ruchu nie mniej niż 80cm optymalnie 90cm. Funkcją zasadniczą platformy jest ruch osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 2: Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie parametrów technicznych dotyczących zakupu i montażu podnośnika dla niepełnosprawnych. W opisie oraz na rysunkach mieszają się określenia i parametry platformy schodowej oraz podnośnika dla niepełnosprawnych. Platforma schodowa nie posiada drzwi oraz ma inne wymiary. Nie może też przewozić wózków dziecięcych z osobą towarzyszącą. Proszę o sprecyzowanie jakie urządzenie Państwo potrzebują i podanie niewykluczających się parametrów.

Odpowiedź: Przetarg dotyczy platformy przyschodowej mocowanej na słupkach/szynie do stopni schodów. W miejscu określenia drzwi w opisie należy rozumieć pałąki/barierki ochronne, po których zwolnieniu wymagane jest światło ruchu nie mniej niż 80cm optymalnie 90cm. Funkcją zasadniczą platformy jest ruch osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 3: Czy przetarg dotyczy platformy przyschodowej montowanej na słupkach do stopni schodów czy platformy w szybie samonośnym? W załączniku przesyłam zdjęcie platformy przyschodowej.

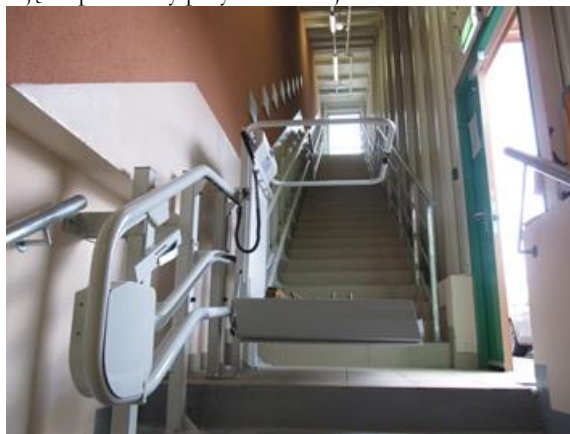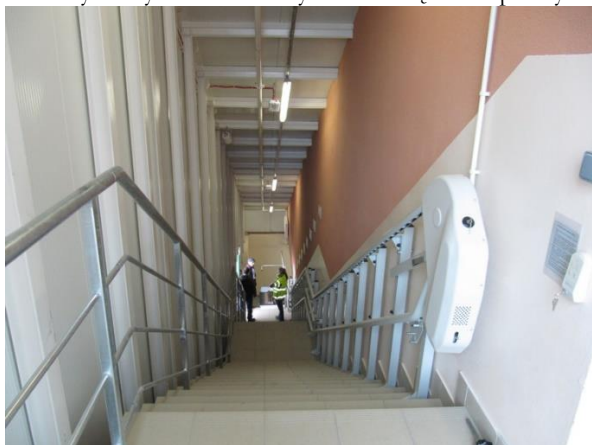

szpitale
wielkopolski

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN



Odpowiedź: Przetarg dotyczy platformy przyschodowej mocowanej na słupkach/szynie do stopni schodów, nie dotyczy platformy w szybie.

Pytanie nr 4: Czy przetarg dotyczy platformy przyschodowej montowanej na słupkach do stopni schodów czy platformy w szybie samonośnym? W załączniku przesyłam zdjęcie platformy przyschodowej.





Odpowiedź:Przetarg dotyczy platformy przyschodowej mocowanej na słupkach/szynie do stopni schodów, nie dotyczy platformy w szybie.

Z poważaniem