



**SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA
W SUWAŁKACH**

Suwałki, dnia 06.08.2018r.

L.dz. SZW.DZI. 331/40/PN/WU/2018

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 40/PN/WU/2018**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby Oddziału Okulistycznego i Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Uczestnik 1

Dot. Część 2 -Zestaw narzędzi wielorazowych do mikrochirurgii okulistycznej

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej miarkę typu Helveston, tytanową, wygiętą po łuku, skala od 0-15, uchwyt płaski?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej pęsetkę do fiksacji typu GRAEFE 6x7 zębów, bez zamka, długość 11 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej hak mięśniowy typu GRAEFE o wymiarach 10 mm/14,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej hak typu Stevens, tępy o wymiarach 6mm/12 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej hak typu Malbran o długości 13 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej szpatułka tęczówka typu WECKER, łopátka szeroka 2 mm, lekko wygięta, długość całkowita 135 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej szpatułka typu SAUTTER, wygięta płytka 15 mm i długości całkowitej 145 mm?

Odpowiedź:

Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji serafinki typu Dieffenbach proste o długości 3,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej imadło typu CASTROVIEJO o długości całkowitej 14 cm, długość chwytka 11 mm, szczęki zagięte o grubości 1,2 mm, bez zamka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej imadło typu CASTROVIEJO delikatne o długości całkowitej 14 cm, długość chwytka 10 mm, szczęki zagięte o grubości 1 mm, bez zamka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej nożyczki rogówkowe, ostrza lekko wygięte dł. 8mm, tępo zakończone, uchwyt płaski, długość całkowita 100 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej pęsetkę rogówkową z ząbkami i platforma do szycia 4 mm, długość całkowita 72 mm, zakrzywiona 45 stopni, ząbki 1x2 o wysokości 0,45mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 18 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej pęsetkę do szycia typu HARMS, szczęki wygięte, gładkie z platforma 6 mm, uchwyt płaski, żeberkowy , długość całkowita 10 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej rozwórka okulistyczna typu CASTROVIEJO, łopatki 15mm fenestrowane, regulowane na śrubie, długość całkowita 9 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 22 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej rozwierak do powiek typu Desmarres, szerokość 14 mm fenestrowany?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ


Poz. 24 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej pęsetkę do powiek typu BERKE, ramiona 20 mm żeberkowane , uchwyt płaski z zamkiem przesuwным, długość całkowita 105 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 25 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości kasetę do sterylizacji o wymiarach 267x160x16 mm z mata silikonową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 26 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej rozwórkę okulistyczną typu LIBERMANN z regulowaną śrubą zakończoną częścią chwytną w kształcie walca o radełkowanej powierzchni. Pozostałe parametry zgodne z Wymogami Zamawiającego.

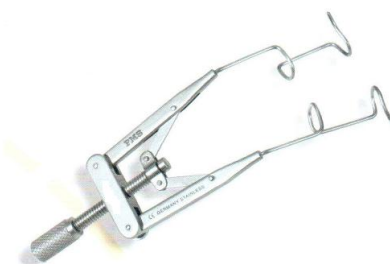

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 27 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej manipulator typu SINSKEY II szerokość części roboczej 0,2 mm, długość całkowita 110 mm, radełkowana okrągła rękojeść?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz.28 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej choper typu Nagahara kąt zakrzywienia 60 °, tępe długość całkowita 105 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 29 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej pęsetkę do kapsuloreksji typu MASKET , ramiona bardzo delikatne wygięte długości 11 mm , , ząbek żeberkowany po wewnętrznej stronie , rękojeść okrągła radełkowana , długość całkowita 100 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 30 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej pęsetkę do szycia typu HARMS, szczęki wygięte, gładkie z platforma 7 mm, uchwyt płaski, żeberkowy , długość całkowita 10 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 31 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie produkcji niemieckiej szpatułka tęczówkowa typu JAFFE, długość szpatułki 10 mm od zagięcia i szerokości 1,0 mm, długość całkowita 115 mm?



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Uczestnik 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu pozycji nr 3 (automatyczny próżniowy procesor tkankowy).

Odpowiedź: Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załączniku nr 5 do SIWZ.

Uczestnik 3

Pytanie 1, dot. części 1:

Uprzejmie prosimy o wyłączenie do oddzielnego pakietu narzędzia i akcesoria, w celu zwiększenia konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2, dot. części 1, pkt 1:

Czy Zamawiający dopuści aparat w konfiguracji z jednorazową endodiatrmią 25 G, bez kroplówki automatycznej (nie ma takiej potrzeby w oferowanym aparacie)- pozostałe cechy spełnione

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3, dot. części 1, pkt 2:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z roboczą pompą Venturii oraz pomocniczą perystaltyczną, pozostałe parametry spełnione

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4, dot. części 1, pkt 3:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z możliwością fakoemulsyfikacji z pompą venturii z możliwością ustawienia parametru przepływu, bez systemu dostrojenia głowicy fako (aparat tego nie wymaga), z częstotliwością pracy głowicy 30 - 46,5 kHz, ze specjalną głowicą do fakofragmentacji, z igłami do U/S typu Kelman, z trybem fako IP. Pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5, dot. części 1, pkt 4:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z pneumatycznym zasilaniem noża do witrektomii (nie elektrycznym), z oświetlaczem ksenonowym, z kasetami oddzielnie do procedury łączonej i fakoemulsyfikacji. Pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6, dot. części 1, pkt 5:

Czy zamawiający dopuści końcówki do endodiatrmii 25 i 27 G, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7, dot. części 1, pkt 6:

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości kontroli wizualnej wartości strumienia świetlnego oraz filtra na dł fali 435 nm, gdyż aparat nie wymaga ww. Pozostałe parametry spełnione

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8, dot. części 1, pkt 7:

Czy zamawiający dopuści aparat z jednorazowymi akcesoriami do podaży oleju silikonowego. Pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 9, dot. części 1, pkt 9:

Czy Zamawiający dopuści aparat bez listwy zasilającej, bez kroplówki z dwoma uchwytami (nie ma takiej potrzeby), z zewnętrznym źródłem zasilania sprężonym powietrzem. Pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10, dot. części 1, pkt 10:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, gdzie interwały terapeutyczne są zawarte w zakresie: 50ms do 1000ms; czas ekspozycji: 50ms do 2000ms, z bezpiecznikiem

250 V, jednofazowy T 5 A, bez bezprzewodowego kontrolera, laser wbudowany w konsolę obsługiwany z ekranu urządzenia, źródło światła z konsoli ksenonowe. Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa: z 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji do 48 godzin.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §1 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*Nie przewiduje się waloryzacji ceny, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2.*”

Uzasadnienie:

Celem uniknięcia wątpliwości, czy cena sama w sobie może ulec zmianie w określonych w umowie przypadkach, zasadnym jest wprowadzenie rekomendowanego zastrzeżenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 13:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §1 ust. 6 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu: „*Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowe szkolenie pracowników Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do prawidłowej, efektywnej i bezpiecznej eksploatacji zainstalowanego sprzętu.*”

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi, aby przeszkolenia pracowników Zamawiającego dokonano jednorazowo, jest to rozwiązanie najbardziej praktyczne. Organizowanie kilku szkoleń dla pojedynczych pracowników jest zbyt uciążliwe i kosztowne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 14:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §1 ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu: *”Wykonawca gwarantuje zadeklarowaną jakość dostarczonego sprzętu, jego niezawodność eksploatacyjną, odpowiednio i solidne wykonanie, przy czym gwarancja co do niezawodności eksploatacyjnej odnosi się jedynie do prawidłowego i zgodnego z instrukcjami udzielonymi na szkoleniu korzystania z dostarczonego sprzętu przez Zamawiającego, oraz, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 26 maja 2015r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz.211 ze zm.) i jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.”*

Uzasadnienie:

Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować niezawodności eksploatacji sprzętu, gdyby ona była np. eksploatowana przez Zamawiającego ponad jej standardowe możliwości i normalne zużycie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 15:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §1 ust. 14 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu: *”W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów urządzeń dostarczonego sprzętu, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych z wyjątkiem takich napraw lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów urządzeń dostarczonego sprzętu, których konieczność przeprowadzenia wynika z korzystania z dostarczonego sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem .*

Uzasadnienie:

Wykonawca nie powinien dodatkowo ponosić kosztów za to, że Zamawiający – mimo przeprowadzenia szkolenia – korzysta z Przedmiotu użyczenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 16:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §1 ust. 17 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu: *”Łączny czas naprawy, t.j. przyjazdu wraz z naprawą serwisu nie dłuższy niż 72 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), chyba że z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wynika, że dokonanie naprawy, mimo należytej staranności, nie jest możliwe w tym terminie.*

Uzasadnienie:

W przypadku gdyby z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wynikało, że naprawa nie jest możliwa w ciągu 72 godz. w dni robocze, Wykonawca nie powinien za to ponosić konsekwencji prawnych, gdyż zgodnie z art. 387 § 1 Kodeksu Cywilnego, świadczenie niemożliwe do zrealizowania jest nieważne. Należy podkreślić, że Wykonawca gwarantuje dostarczenie aparatu zastępczego na czas trwania napraw.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 17:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §1 ust. 18 projektu umowy w następującym brzmieniu: *”W okresie gwarancji trzy istotne naprawy powodują wymianę sprzętu lub modułu zawierającego uszkodzony podzespół na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 10 lat, o ile te części w tym okresie będą dostępne na rynku producentkim.*

Uzasadnienie:

- pojęcie „naprawy” jest pojęciem szerokim, może zawierać w sobie także naprawy błahe; konieczność wymiany podzespołu na nowy przy trzech naprawach, które nie są istotne, będzie generowało po stronie Wykonawcy dodatkowe koszty, wobec tego naprawy te powinny być obwarowane przymiotem istotności;

- Wykonawca jest w stanie zapewnić dostępność części zamiennych jedynie w przypadku, gdy będzie możliwe ich wykupienie na rynku. Obciążenie Wykonawcy odpowiedzialnością za brak części zamiennych na rynku jest nieważne, Wykonawca bowiem nie będzie w stanie obiektywnie zrealizować takiego obowiązku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §2 ust. 6 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu: *”Jeśli Zamawiający w trakcie eksploatacji sprzętu stwierdzi iż towar zawiera wady do których powstania nie przyczynił się Zamawiający, Zawiadamia telefonicznie bądź pisemnie (w tym drogą elektroniczną) Wykonawcę o zaistniałym fakcie a Wykonawca w terminie trzech dni roboczych od daty dostarczenia mu przez Zamawiającego towaru (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), dokonuje wymiany towaru wadliwego na towar bez wad.*

Uzasadnienie:

-W przypadku istnienia wad, do których istnienia przyczynił się Zamawiający, Wykonawca nie powinien być zobligowany do wymiany towaru na nowy;

- Wykonawca nie może odnieść się do wad sprzętu, jeśli naocznie go nie zbada. Zasadnym jest, aby termin wymiany towaru wadliwego na towar bez wad biegł od momentu dostarczenia wadliwych towarów do Wykonawcy. Dostarczenie towarów powinno być obowiązkiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §4 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„Naruszenie przedmiotowego zakazu określonego w niniejszym paragrafie skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wartości netto wierzycielności , którą nabyła niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej, osoba trzecia.*

Uzasadnienie:

- Dotychczasowe brzmienie w postaci „przedmiotowego zakazu” było nieprecyzyjne. Należy dookreślić, iż chodzi o zakazy opisane tylko i wyłącznie w § 4;

- Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest wartość netto i to od tej wartości powinny być obliczane kary umowne;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 20:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §5 ust. 1 – 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej realizacji umowy w wysokości*

0,5 % wartości wynagrodzenia **netto** za każdy dzień **zwłoki** ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy, **ale nie więcej niż 10% wartości netto zamówienia**.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia **netto** za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone, odpowiednio w § 2 ust. 6 umowy, **ale nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego towaru**

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku **zwłoki** w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia **netto** za każdy dzień **zwłoki** liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, **ale nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego towaru**.

4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości równoważącą 10 % **niezrealizowanej części** wynagrodzenia **netto** określonego w § 1 ust. 2 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy."

Uzasadnienie:

- Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, a nawet Zamawiającego, co sprawia, że niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy w przypadku opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę;

- Kara umowna za nieterminową realizację obowiązków gwarancyjnych powinna być naliczana w oparciu o wartość tych konkretnych wadliwych towarów, a nie całego zamówienia, w skład którego one wchodziły, pozostałe elementy dostawy będą bowiem dostarczone zgodnie z umową;

- Kara umowna za odstąpienie od umowy powinna być ustalana w oparciu o wartość jeszcze niezrealizowaną, w przeciwnym wypadku, w sytuacji gdy odstąpienie od umowy miało miejsce po zrealizowaniu zdecydowanej większości umowy, kara umowna mogłaby przekroczyć wartość jeszcze niezrealizowanej części, co byłoby krzywdzące dla Wykonawcy;

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §6 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że zmiany określone w ust. 2 pkt 1.2 wchodzi w życie automatycznie z dniem wejścia w życie stosownych przepisów, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”*

Uzasadnienie:

Zmiana stawki VAT jest okolicznością całkowicie niezależną od woli stron, podatek od towarów i usług powinien też mieć charakter neutralny dla podmiotów będących jego płatnikami. Ponadto, z uwagi na to, że zgodnie z art. 32 ustawy PZP tylko wartość netto stanowi wartość zobowiązania, zasadnym jest przyjęcie, że w przypadku zmiany stawki VAT nowa stawka będzie stosowana automatycznie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 22:

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 6 ust. 6 pkt 1-4 projektu umowy oraz przyjęcie pkt 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„trzykrotnego naruszenia istotnych postanowień umowy przez drugą stronę umowy”*.

Uzasadnienie:

- Zamawiający nie powinien mieć prawa do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności zmieniającej sytuację Zamawiającego np. zmiany zasad jego współpracy z NFZ. Wykonawca nie ma żadnego wpływu na te relacje ani na sytuację Zamawiającego. Odstąpienie od umowy powinno być dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach, które są wskazane w przepisach powszechnie obowiązujących.

- Naruszenie istotnych postanowień umowy powinno być określone na poziomie minimalnym w postaci trzech naruszeń, aby to była podstawa rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Uczestnik 4

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy Część nr 3 :

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą niewykraczającą poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów :

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §1 ust. 2 umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy Część nr 3:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §3

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy Część nr 3:

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis w § 5 ust.7 o następującej treści :

„ *Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.* ”

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy Część nr 3:

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury”? Obligatoryjnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający ma w namyśle fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5

Dotyczy Części nr 3:

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym niebezpieczne opary odczynników są w sposób ciągły odprowadzane z szafki na odczynniki oraz znad komory reakcyjnej w momencie jej otwarcia w celu włożenia lub wyjęcia koszyków. Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego, ponieważ pozwala na efektywną ochronę użytkownika podczas pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz.9

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z dotykowym kolorowym ciepłokrystalicznym 12,2 cala wyświetlaczem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 13

Ze względu na fakt iż rutynowo w pracowniach stosowanych jest od 2-3 programów, prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego możliwość konfiguracji 8 programów (każdy składający się z 14 kroków) z możliwością konfiguracji parametrów: temperatura, czas, odczynnik, ciśnienie/ próżnia, oraz możliwością przechowywania większej liczby programów na zewnętrznym nośniku danych W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o przedstawienie minimum 10 programów (każdy po 14 kroków), jakich będzie używał Zamawiający wraz z informacją o ich zastosowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 14

Ze względu na fakt iż rutynowo w pracowniach stosowanych jest od 2-3 programów, prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego możliwość konfiguracji 8 programów (każdy składający się z 14 kroków) z możliwością konfiguracji parametrów: temperatura, czas, odczynnik, ciśnienie/ próżnia, oraz możliwością przechowywania większej liczby programów na zewnętrznym nośniku danych. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o przedstawienie minimum 10 programów (każdy po 14 kroków), jakich będzie używał Zamawiający wraz z informacją o ich zastosowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 15

Prosimy o poprawę oczywistej pomyłki pisarskiej – czas kroku w programie nie może wynosić 0

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż czas kroku liczony jest od 0 w górę

Poz. 18

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w komplet plastikowych koszy pozwalających na ułożenie kasetek w postaci luźnej i uporządkowanej. Zwracamy Zamawiającemu uwagę na fakt iż plastikowe kosze są lepsze w użytkowaniu, nie ulegają procesowi korozji w kontakcie z odczynnikami, co ma miejsce w przypadku tworzywa jakim jest metal. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 19

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem regulacji temperatury odczynników w retorcie od temperatury pokojowej do 55°C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 20

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z niewymiennymi pojemnikami w ilości 9 szt. plus wymienne 2 pojemniki plus dwa pojemniki wymiany. O pojemności 5 litrów każdy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 21

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z 3 pojemnikami na odczynniki do czyszczenia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 23

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z systemem zarządzania odczynnikami umożliwiające monitorowanie wykorzystania odczynników poprzez pomiar stężenia alkoholu, ilości cykli, dni. Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ, ponieważ pozwala użytkownikowi na realny dostosowanie częstotliwości wymian poszczególnych odczynników w zależności od faktycznego stanu odczynnika w urządzeniu. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 24

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w system automatycznego uruchamiania programów z funkcją automatycznego rozpoznawania programu dziennego i nocnego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 3 łaźnie parafinowe o pojemności 5 litrów każda oraz wyposażonego w wyjmowany jednorazowy pojemnik (niewymagający czyszczenia) na zużytą parafinę. Jest to rozwiązanie równoważne do opisanego w SIWZ. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 26

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem nastawiania temperatury w łaźniach od 45°C do 65°C. Zakres ten jest wystarczający do rozpuszczenia parafiny w wymaganym przez Zamawiającego zakresie, a co za tym idzie jest to rozwiązanie bezpieczniejsze dla przeprowadzanej tkanki, ponieważ uniemożliwia kontakt zbyt gorącego odczynnika z materiałem. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z możliwością napełniania/wymiany odczynników poprzez dedykowane rurki transferowe pozwalające na zdalne napełnianie/wymianę zarządzane za pomocą ekranu kontrolnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 37

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach: Szerokość: 670mm, głębokość: 520mm, wysokość: 1600mm i wadze 112 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju wynosił 5 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .

Poz. 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych z zagranicy wynosił 10 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający zmienił załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na obowiązującym załączniku .

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert: 09.08.2017r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 09.08.2017r. godz. 12:00

Treść niniejszego pisma stanowi uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30/07/2018r. i została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szalanda