



Poznań, 26.03.2024 r.

ADZP-381-30/24

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w trybie podstawowym bez negocjacji w przedmiocie: **"Zakup sprzętu medycznego dla Pododdziału Ginekologicznego oraz Bloku Porodowego w Szpitalu św. Rodziny"**, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1** Pytania do części 1 - Lampa diagnostyczno-zabiegowa. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy ze średnicą oprawy 58,5 cm, co zapewni większą bezcieniowość urządzenia?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 2** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy ze zdejmowanym, sterylizowanym uchwytem umieszczonym w osi symetrii oprawy oświetleniowej, co pozwala na bardziej ergonomiczne pozycjonowanie urządzenia?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 3** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z matrycą diodową składającą się z 44 diod LED? Ilość diod LED nie powinna być parametrem wykluczającym pod warunkiem spełnienia innych wymogów technicznych odnośnie oświetlenia i energooszczędności.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 4** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z temperaturą barwową regulowaną w 5 krokach 3500-4000 4500-5000-5500K, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 5** Ad 15 Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy oprawy 28 cm?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 6** Ad 17,25 Czy Zamawiający dopuści Lampę o średnicy pola oświetleniowego 13-24,5 cm? Regulacja pola odbywa się za pomocą pozycjonowania kopuły w dół lub w górę?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 7** Ad 19 Czy Zamawiający dopuści lampę która posiada 25 diod LED? Jest to różnica niewielka niezauważalna dla ludzkiego oka.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 8** Ad 21 Czy Zamawiający dopuści lampę posiadającą jeden zintegrowany uchwyt brudny? Jest to rozwiązanie ergonomiczne, intuicyjne i wystarczające.

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 9** Ad 26 Czy Zamawiający dopuści lampę z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000- 4400-4800K? Parametr lepszy od wymaganego.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 10** Ad 30 Czy Zamawiający dopuści lampę o łączmy poborze mocy 55W? Jest to niewielka różnica od wymaganego

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 11** Ad 32 Czy zamawiający dopuści lampę z czterostopniową regulacją natężenia za pomocą panelu umieszczonego przy oprawie ? Jest to parametr wystraszająco dobry

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 12** Ad 34. Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu gwarancyjnego max do 5 dni roboczych?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13** Ad 35. Czy Zamawiający wydłuży czas usunięcia usterki do 7 dni roboczych?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 14** Ad 36. Czy Zamawiający wydłuży czas wstawiania urządzenia zastępczego przy naprawie powyżej 7 dni roboczych?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 15** Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

**Odpowiedz: Strop lany żelbeton obniżony o sufit podwieszany.**

**Pytanie 16** Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

**Odpowiedz: Wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego 3 m, wysokość od sufitu podwieszanego do stropu właściwego 54 cm.**

**Pytanie 17** Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

**Odpowiedz: Nie przewiduje się zasilania awaryjnego w salach.**

**Pytanie 18** Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

**Odpowiedz: Nie ma takiej możliwości, ponieważ piętro wyżej mieści się blok operacyjny szpitala.**

**Pytanie 19** Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

**Odpowiedz: Tak, lampy będą zamontowane w tych samych miejscach.**

**Pytanie 20** Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

**Odpowiedz: W salach są komplety instalacji elektrycznej.**

**Pytanie 21** Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?

**Odpowiedz: Producent firmy Famed Łódź- ścienna, Erbe- sufitowa.**

**Pytanie 22** Załącznik nr 2, Zamówienie częściowe nr 1 Czy Zamawiający dopuści lampy z regulacją natężenia wykonywaną zgodnie z opisem wymagań z panelu sterowania umieszczonego na ramieniu lampy bezpośrednio przy oprawie oraz uchwyt sterylizowalny do regulacji wielkości pola operacyjnego i pozycjonowania oprawy oświetleniowej?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 23** Zamówienie częściowe nr 1 - Lampa diagnostyczno-zabiegowa

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampy diagnostyczno-zabiegowej o następujących parametrach: Natężenie 120.000 lux Temperatura barwowa światła: 4500K/5000K Współczynnik odwzorowania barwy CRI Ra 95 Regulacja średnicy pola operacyjnego: 11-33 cm Źródło światła 28 Diod LED Regulacja natężenia światła: 20-100% Głębokość ostrości zgodnie z normą IEC 60601-2-41 (L1+L2) przy 60% 92 cm Głębokość ostrości zgodnie z normą IEC 60601-2-41 (L1+L2) przy 20% 155 cm Regulacja natężenia w 8 stopniowa Panel regulacji umieszczony na czaszy lampy Żywotność diod: 60.000 h Pobór mocy 51 VA Zasięg ramienia z czaszą 186cm Zewnętrzna średnica czaszy: 40 cm 2szt uchwyty sterylizowalnych.

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuści.**

**Zamówienie częściowe nr 1 – Lampa diagnostyczno - zabiegowa**

**Pytanie 24** Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?

**Odpowiedz: Strop lany żelbeton.**

**Pytanie 25** Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

**Odpowiedz: Tak, występuje sufit podwieszany, wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego 3 m, a odległość od stropu 354 cm.**

**Pytanie 26** Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy?

Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?!


**Odpowiedz: W miejscu montażu jest wprowadzone zasilanie lamp.**

**Pytanie 27** Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

**Odpowiedz: Tak, wisi lampa. Producent to Erbe Mach led 150 oraz Famed Łódź Medilux BHW 175.**

**Pytanie 28** Prosimy o podanie następujących informacji:


**Odpowiedz: A - 354 cm,  
B - 300 cm,  
C - 54 cm.**

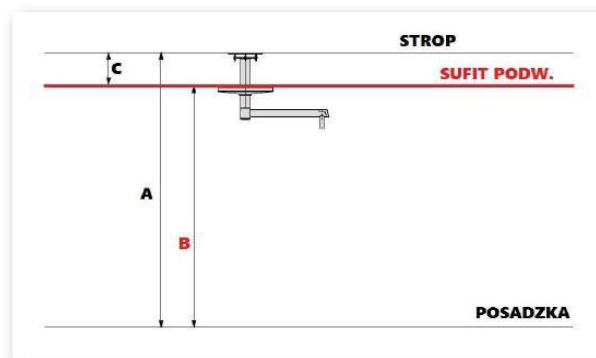

- A. Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / **żelbeton** / inny:..... ]  
 B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / **kasetony** GK (50x50 lub **60x60**) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny: ..... ]  
 C. Dystans pomiędzy A i B

**Odpowiedz: A- żelbeton, B- kasetony 60x60, C- A i B.**


**Pytanie 29** pkt 7. Czy Zamawiający dopuści lampę o następującym zawieszaniu?

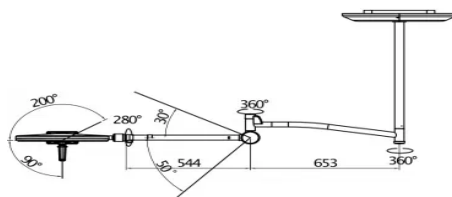

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 30** pkt 8. Czy Zamawiający dopuści lampę o następującym zawieszaniu?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuści.**

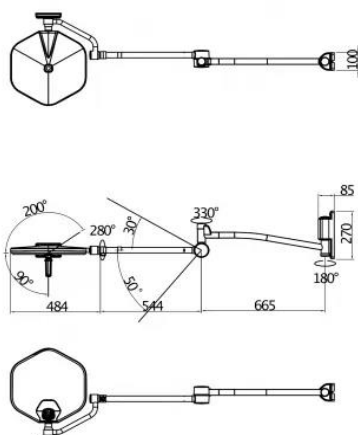

**Pytanie 31** pkt. 13. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu fasetowania układu optycznego, będącego autorskim opisem producenta?

**Odpowiedz: Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu fasetowania układu optycznego.**

**Pytanie 32** pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści lampę o kształcie jak poniżej:



**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 33** pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy 43,5 cm?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 34** pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści lampę bez uchwytów brudnych, a z uchwytem sterylizowanym znajdującym się w części bocznej lampy?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 35** pkt. 23 Prosimy o wyjaśnienie jaki parametr Zamawiający rozumie jako zakres roboczy?

**Odpowiedz: Zakres roboczy – zakres pola roboczego, w którym lampa utrzymuje swoje parametry świetlne.**

**Pytanie 36** pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3800 / 4300 / 4800 K?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 37** pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści lampę z całkowitym poborem mocy lampy max 61VA?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 38** pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści lampę z całkowitym poborem mocy lampy max 84VA?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuści.**

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**

/ - / Marek Dakowski

---

Sprawę prowadzi: Agata Szulczyk, +48 61 61 62 558, [agata.szulczyk@szoz.pl](mailto:agata.szulczyk@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
ul. Adama Wrzóska 1  
60-663 Poznań