

Suwałki, dnia 23/06/2020r.

L.dz. SZW.DZI.262. 191/22/PN/MN/2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 22/PN/MN/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Uczestnik 1

Dotyczy zadania 27

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający może wyłączyć z pakietu nr 27 dwa typy lamp produkcji Pentax w celu utworzenia odrębnego pakietu ?

4	Lampa ksenonowa EPK 100 Pentax	XL-103/05	1
6	Lampa ksenonowa do wideoprocatora Penatx EPK-i5000 ME 300BF	CE-317	1

Uzasadnienie : Utworzenie jednego pakietu dla lamp firmy Pentax pozwoliłoby na prawidłowe i profesjonalne zrealizowanie zakresu zamówienia. Firma Varimed jest jedynym autoryzowanym serwisem firmy PENTAX w Polsce co pozwala nam mieć dostęp do oryginalnych części producenta

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy wzór umowy § 1 ust. 2

Czy zamawiający zgodzi się na rozszerzenie ustępu 2 o następującą treść:

2) „Ilość określona w załączniku nr 1trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie , **z zastrzeżeniem, że poziom wykonania umowy musi osiągnąć min. 70% wartości**”

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy wzór umowy § 4 ust. 1 i 2

Czy zamawiający zgodzi się na rozszerzenie ustępu 1 i 2 o następującą treść:

- 1) Zamawiający zastrzega w terminie określonym w § 1 ust.9 umowy, **a reklamację uznał za zasadną**
- 2) Zamawiający zastrzega sobie zamówień złożonych przez Zamawiającego , **o ile fakt ich niewykonania nie jest efektem zwłoki w płatnościach za uprzednio zrealizowane zamówienia**

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy wzór umowy § 5 ust. 3 oraz dopisanie kolejnego

Czy zamawiający zgodzi się na rozszerzenie ustępu 3 **oraz dopisanie kolejnego** o następującą treść:

- ~~3) Wykonawca nie może odmówić..... u Zamawiającego , **chyba, że zwłoka w płatnościach przekracza 30 dni.**~~

) „ W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze, wykonawca ma prawo wstrzymać realizację umowy bądź wykorzystać przedmiot zamówienia w formie płatności : „Przedpłata” lub „Za pobraniem”

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy wzór umowy § 7 ust.1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w zakresie zmniejszenia kar umownych ?

- 1) z 0,5% na 0,2%
- 2) z 0,5% na 0,2%

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Uczestnik 2

Pytanie 1 Pakiet 23 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wskazanie czy elektrody mają być dla dzieci czy dla dorosłych?

Odpowiedź: dla dorosłych

Pytanie 2 Pakiet 23 poz.1

Prosimy Zamawiającego o weryfikacji jakich ilości oczekuje Zamawiający-elektrody są kompletowane po 4szt.

Odpowiedź:10 kompletów.

Pytanie 3 Pakiet 23 poz.2

Prosimy Zamawiającego o wskazanie czy elektrody mają być dla dzieci czy dla dorosłych?

Odpowiedź: dla dorosłych

Pytanie 4 Pakiet 23 poz.2

Prosimy Zamawiającego o weryfikacji jakich ilości oczekuje Zamawiający-elektrody są kompletowane po 6szt.

Odpowiedź: 10 kompletów.

Pytanie 5 Pakiet 23 poz.4,5,6

Prosimy Zamawiającego o wskazanie rodzaju zakończenia od strony pacjenta do ww. kabli.

Odpowiedź: zakończenie banan.

Pytanie 6 Projekt umowy- §2 ust. 1

W celu terminowej realizacji dostaw wnioskujemy aby do projektu umowy dopisać , że:

„ Zamówienia składa się do godziny 12:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym”

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 SIWZ

Prosimy Zamawiającego o określenie ilości dostaw w miesiącu, tak aby Wykonawca mógł oszacować dokładnie koszty transportu.

Odpowiedź: brak możliwości określenia ilości dostaw w miesiącu. Dostawy w zależności od potrzeb oddziałów szpitalnych

Uczestnik 3

PAKIET 11

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o informację czy w kardiomonitorach Carescape B 450 na wyposażeniu zamawiającego posiada technologię Masimo SET?

Odpowiedź: Tak posiadana aparatura jest w technologii Masimo SET

Pytanie 2

Technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology) , to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafalszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym zamawiający wymaga od składających ofertę aby zapewnili czujniki wielorazowe saturacji SPO2 do wielorazowego użytku typu Y dla noworodka do kardiomonitora Carescape B 450 wykonanej w technologii Masimo SET potwierdzając kompatybilność pismem załączonym wraz z oferta od autoryzowanego serwisu Masimo w Polsce lub producenta Masimo Polska?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

PAKIET 16

Pytanie 1

Prosimy zamawiającego o potwierdzenie czy w urządzeniu defibrylatora Lifepak 15 znajduje się technologia pomiaru saturacji Masimo SET i czy w związku z tym Zamawiający wymaga dostarczenia w pozycji 1 i 2 czujników wykonanych w technologii Masimo SET zgodnie z zaleceniami producenta Modułu SpO2 w urządzeniu Lifepak 15 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników z technologią Masimo SET

Pytanie 2

Technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology) , to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafalszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym zamawiający wymaga od składających ofertę aby zapewnili czujniki wielorazowe saturacji SPO2 do urządzenia Lifepak 15 wykonanej w technologii Masimo SET potwierdzając kompatybilność pismem załączonym wraz z oferta od autoryzowanego serwisu Masimo w Polsce lub producenta Masimo Polska?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

PAKIET 17

Pytanie 1 Pozycja 2


Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga czujnika dla dorosłych bezpośredniego wykonanego w technologii Masimo SET o długości 365 cm do urządzenia Lifepak 12 wyposażonego w technologię Masimo SET takim jak na zdjęciu poniżej?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujnika 14- pinów

Pytanie 2 Pozycja 2

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga czujnika wielorazowego dla dorosłych o połączeniu LNCS wykonanego w technologii Masimo SET o długości 90 cm do urządzenia Lifepak 15 wyposażonego w technologię Masimo SET takim jak na zdjęciu poniżej?

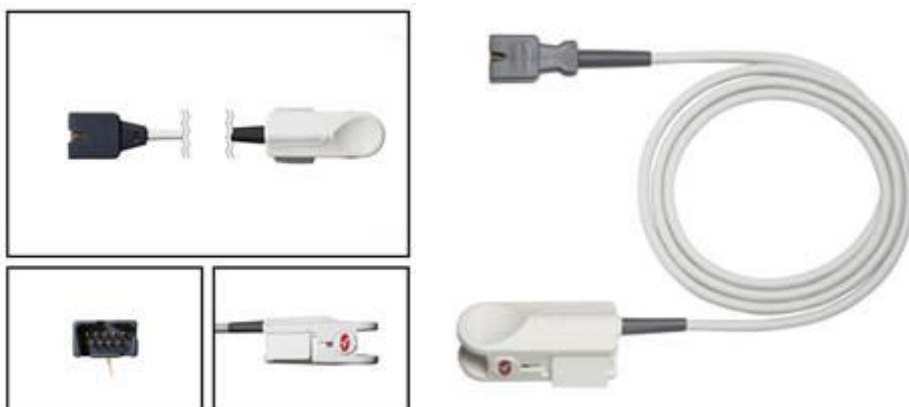

Odpowiedź: Długość czujnika 90 cm

Pytanie 3 Pozycja 1 i 2

Technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology) , to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafałszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym zamawiający wymaga od składających ofertę aby zapewnili czujniki wielorazowe saturacji SPO2 do urządzenia Lifepak 12 i 15 wykonanej w technologii Masimo SET potwierdzając kompatybilność pismem załączonym wraz z oferta od autoryzowanego serwisu Masimo w Polsce lub producenta Masimo Polska?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

PAKIET 22

Pytanie 1

Prosimy zamawiającego o podanie dl czujnika bezpośredniego gdyż firma Masimo oferuje dwie długości 90 cm oraz 365 cm?

Odpowiedź: 365cm.

M.N./M.N.

Pytanie 2

Technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology) , to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafalszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym zamawiający wymaga od składających ofertę aby zapewnili czujniki wielorazowe saturacji SPO2, SpCO, SpMet wykonane w technologii Masimo SET potwierdzając kompatybilność pismem załączonym wraz z oferta od autoryzowanego serwisu Masimo w Polsce lub producenta Masimo Polska?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 1

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Uczestnik 4

PAKIET 4

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie czujnika przeznaczonego dla dzieci o wadze od 1 do 20 kg.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

PAKIET 11

Poz. 1

Prosimy o podanie, w jakiej technologii ma pracować czujnik.

Odpowiedź: Czujniki w technologii Masimo SET

PAKIET 20

Poz. 2, 15

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 34-47 cm

M.N./M.N.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 6-11 cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 22/PN/MN/2020 z dnia 18/06/2020r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach