

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 10/10PN/2020/29

Bytom dnia: 2020-06-29

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Dotyczy: Pakiet Nr 29 SONDA DO KOAGULACJI PLAZMOWO-ARGONOWEJ

Pytanie nr 1 dotyczy poz. 1 – (Sonda do koagulacji plazmowo-argonowej wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, minimalna długość robocza 220 cm., współpracująca z aparatem ERBE ICC 200)

Czy zamawiający dopuści sondy do koagulacji plazmowo-argonowej wielorazowego użytku jednorazowe, średnica 2,3mm oraz długość 220cm, współpracująca z aparatem ERBE ICC 200? Jedno opakowanie zawiera 10 szt. jednorazowych elektrod plazmowo-argonowych.

Powodem przejścia z sondy wielorazowej na sondę jednorazową jest zaprzestanie produkcji sondy wielorazowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga Sondy wielorazowego użytku.

Dotyczy: Pakiet Nr 32 OPRZYRZĄDOWANIE DO ELEKTROKOAGULACJI DO APARATU ERBE ICC 200

Pytanie nr 2 dotyczy poz. UWAGA (GWARANCJA NA ZAOFEROWANE NARZĘDZIA MINIMUM 24 MIESIĄCE)

Czy zamawiający zmieni zapis SIWZ pod kątem gwarancji, mianowicie wszystkie nasze instrumenty wielorazowe (jako narzędzia operacyjne zużywalne, intensywnie pracujące) posiadają gwarancje 12 miesięcy. Gwarancja 24 miesięcy jest oferowana w momencie dużych aparatów (miedzy innymi diatermii). Natomiast na oprzyrządowanie jednorazowego użytku nie operujemy nazewnictwem gwarancja lecz, przydatność użytkowania (ograniczona terminem ważności) w naszym przypadku jest to minimum 24 miesiące od momentu zamówienia, na każdy osprzęt jednorazowego użytku. W takim wypadku proszę o zmianę warunków gwarancyjnych na 12 miesięcy dla wyrobów wielorazowego użytku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, gwarancje na 12 miesięcy.

Pytanie nr 3 dotyczy poz. 3 (Szczypce biopolarne proste, szerokość 2 - 3 mm, długość 220 mm)

Czy zamawiający dopuścić szczypce bipolarne proste z końcówkami o szerokości 2mm oraz długość pincety 225mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 dotyczy poz. 6 (Elektroda monopolarna kulka 5 mm, dł.5 cm)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody o długości 4cm, reszta parametrów zgodna z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet Nr 125 - OPRZYRZĄDOWANIE DIATERMII CHIRURGICZNEJ ERBE II

Pytanie nr 5 dotyczy poz. 3 (Elektroda czynna typu igła sr 0,4 mm)

Czy zamawiający dopuści elektrodę czynną typu igła o śr 0,8mm? Reszta wymogów zgodnie z SIWZ.

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nr 6 dotyczy poz. 4 (Elektroda czynna nóż prosty dł 25mm szer 3,5)

Czy zamawiający dopuści elektrodę czynną nożową prostą o długości 24 mm i szerokości 3,4mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet Nr 126 OPRZYRZĄDOWANIE DIATERMII CHIRURGICZNEJ EBE I

Pytanie nr 7 dotyczy poz. 10 (Szczypce bipolarne proste szer 2-3 mm dł 22cm)

Czy zamawiający dopuści kleszczyki o długości 22,5cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:



Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy poz. 11 (Kleszczyki bipolarne koagulujące zaciskowe izolowany trzebień dł 330mm śr 5mm końcówka dł 15mm szer 4mm rozwarcie 18mm instrument kompletny)

Czy zamawiający dopuści kleszcze bipolarne koagulacyjne ze średnicą 5mm, okienkowe, o dł. 340mm, instrument kompletny, funkcjonalnością nie odbiegają od kleszczyków zawartych w specyfikacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

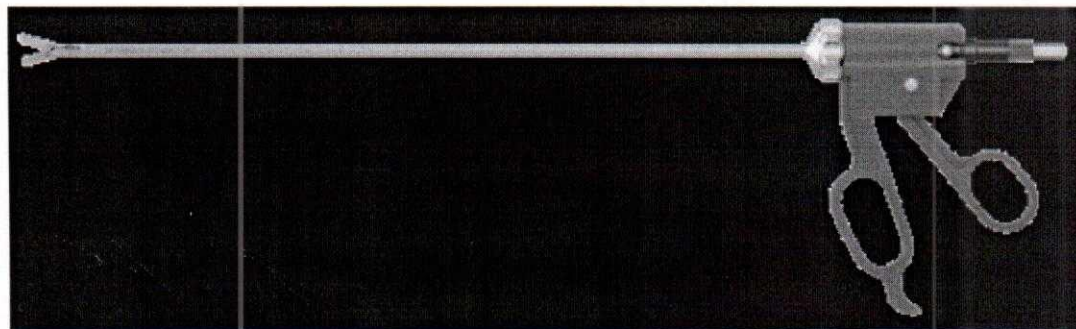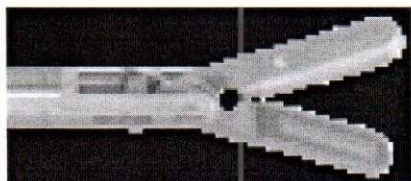

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy: Pakiet Nr 133 OPRZYRZĄDOWANIE DIATERMII CHIRURGICZNEJ EBE VIO 300D

Pytanie nr 9 dotyczy poz. 9 (Szczypce bipolarne proste szer 2-3 mm dł 22cm)

Czy zamawiający dopuści kleszczyki o długości 22,5cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. :

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie nr 10 dotyczy poz. 10 (Kleszczyki bipolarne koagulujące zaciskowe izolowany trzebień dł 330mm śr 5mm końcówka dł 15mm szer 4mm rozwarcie 18mm instrument kompletny).

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy zamawiający dopuści kleszcze bipolarne koagulacyjne ze średnicą 5mm, okienkowe, o dł. 340mm, instrument kompletny, funkcjonalnością nie odbiegają od kleszczyków zawartych w specyfikacji?



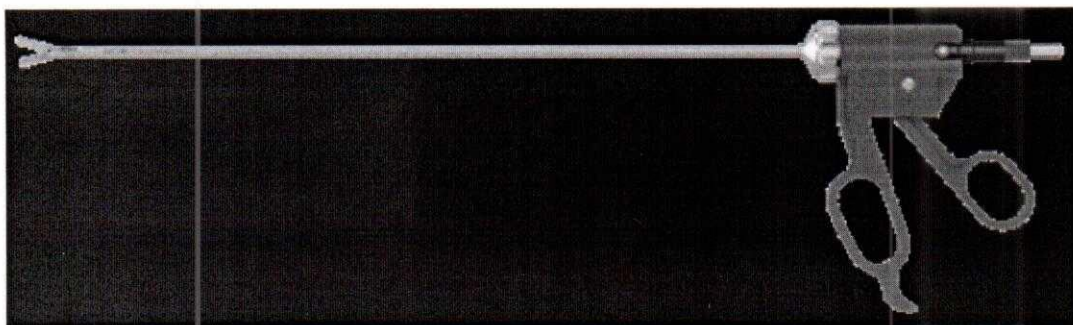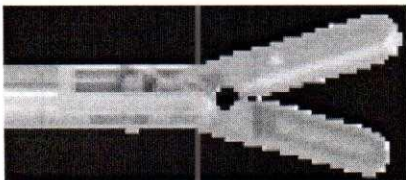

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name.