



WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRAC ADAPTACYJNYCH

1. Demontaż starego tomografu (bez uszkodzania) i transport we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Szpitala
2. Droga transportowa – winda (wymiary w przybliżeniu 130cmx200cmx260cm, udźwig 2000kg)
3. Na potrzeby zainstalowania nowego tomografu komputerowego Zamawiający stawia do dyspozycji cztery pomieszczenia dotychczasowej Pracowni Tomografii Komputerowej o następujących powierzchniach: 31,41 m, 19,06 m, 7,02 m, 13,48 m. Rzut piętra w załączeniu.
4. Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego wraz z dostarczeniem tablicy zasilającej z zabezpieczeniami, dostosowanie instalacji elektrycznej (kabel dochodzący YKY 4x50mm²) i wykonaniem naprawy posadzki po ewentualnej modernizacji kanałów zasilających i posadowieniu TK.
5. Połączenie z RIS oraz PACS, połączenie 10 Gigabitowe (światłowód wielomodowy) pomiędzy urządzeniem a serwerownią, w której zainstalowany jest PACS
6. Wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniu gabinetu i opisowni wg obowiązujących przepisów dotyczących zakładów radiologicznych z zastosowaniem reżimu sanitarnego i ochrony radiologicznej. Posadzki wykończone wykładzinami antyelektrostatycznymi.
7. Malowanie ścian w pomieszczeniu gabinetu i opisowni z pokryciem zapewniającym całkowitą zmywalność.
8. Wymiana drzwi elektrycznych: A. korytarz- sterownia- gabinet, B. sterownia- gabinet.
9. Zapewnienie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach zabiegowych i technicznych z przedłożeniem pomiarów skuteczności wentylacji. Wymiana klimatyzatorów.
10. Po wygraniu przetargu i przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca przedstawi akceptację projektu przez uprawnione instytucje, potwierdzającą spełnienie wymagań ochrony radiologicznej i warunków sanitarnych.
11. W przypadku gdy wartość wymaganej oporności wewnętrznej linii zasilającej jest niewystarczająca dla danego aparatu, należy uwzględnić wykonanie nowej linii zasilającej.
12. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje także adaptację (w zależności od potrzeb oferowanego urządzenia) wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w zakresie niezbędnym do zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁ TECHNICZNY
SEKCJA APARATURY MEDYCZNEJ

Krzysztof Chmura

p.o. KIEROWNIK
DZIAŁ TECHNICZNY

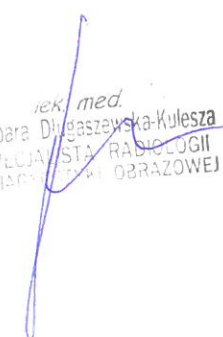Krzysztof Sworek

lek. med.
Barbara Długaszyńska-Kulesza
SPECJALISTA RADIOLOGII
I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

6062362